


Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 17.03.2025 r.

Znak postępowania: **DTA.251.2.3.2025**

Nazwa postępowania: **Dzierżawa analizatora do badań immunochemicznych wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych, kontrolą międzynarodową, dostawą chłodziarko-zamrażarki oraz laboratoryjnego systemu informatycznego do pracowni biochemiczno-immunologicznej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.**

PYTANIA:

1. Do Załącznika nr 1a do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p.9:
Czy pod określeniem *"krzywe kalibracyjne opracowane przez producenta, wczytywane automatycznie do analizatora"* Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?
Odpowiedź: Tak - Zamawiający wyraża zgodę.
2. Do Załącznika nr 1a do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, p.12:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym ze względu na zastosowaną technologię pomiar i odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a użycie jednorazowych końcówek dozujących oraz jednorazowych kuwet reakcyjnych zabezpiecza przed ryzykiem kontaminacji i carry-over.
Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.
3. Do Załącznika nr 1b do SWZ:
Czy Zamawiający oczekuje aby oferowane odczynniki do oznaczania TSH, fT4, fT3, anty-TPO i anty-Tg posiadały określone przez producenta odczynników specyficzne wartości referencyjne dla populacji niemowląt, dzieci i kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach dla populacji europejskiej, co pozwoli prawidłowo interpretować wyniki oznaczeń tych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
4. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu zapewnienia integracji z LIS oraz dostępu do internetu?
Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.
Oferowane analizatory oraz systemy wymagają do pracy stałego połączenia z internetem. Jest to związane z aktualizacją licencji oprogramowania, pobieraniem danych o odczynnikach, kontrolach, kalibratorach, serwisem zdalnym oraz połączeniem z LIS. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na spacyfikowanych portach. Poniżej schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

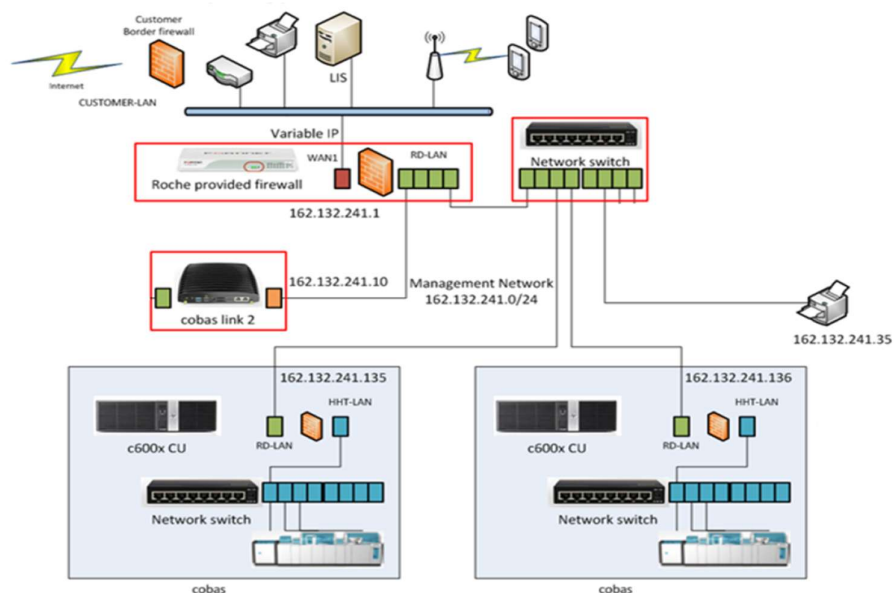

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

zał. nr 3 projektowane postanowienia umowy

7. par. 2 ust. 4 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

8. par. 2 ust. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wskazanych dokumentów drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można dokumenty tej formie wysłać?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje elektroniczne dane kontaktowe do realizacji tego punktu umowy tj. dane zawarte w par. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanych postanowień umowy.

9. par. 2 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po

bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

10. par. 3 ust. 2 pkt 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia w zakresie ubezpieczenia poprzez wskazanie, iż nie dotyczy ono dzierżawionej aparatury?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

11. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę i wskazuje elektroniczne dane kontaktowe do realizacji tego punktu umowy tj. dane zawarte w par. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanych postanowień umowy.

12. par. 4 ust. 1 Zgodnie z k.c. udzielenie gwarancji jest świadczeniem dodatkowym (sprzedawcy – gwaranta) charakterystycznym dla umowy sprzedaży. Tymczasem Zamawiający będzie korzystał ze sprzętu na podstawie umowy dzierżawy. W związku z powyższym, Wykonawca powinien ponosić odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie sprzętu w sprawności na zasadzie art. 662 §1 k.c. w zw. z art. 694 k.c.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z paragrafu 4. zapisów dot. gwarancji i ustalenie, że Wykonawca odpowiada „w okresie obowiązywania umowy za zapewnienie sprawności technicznej i użytkowej aparatu oraz usuwanie usterek”?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

13. par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

14. par. 4 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

15. par. 4 ust. 11 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

16. par. 5 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna była liczona od „niezrealizowanej wartości umowy brutto”? Specyfika realizacji przedmiotu Umowy, polegającego na świadczeniu ciągłym, przez okres ustalony w kontrakcie, czyni nieuzasadnionym naliczanie kar, w stosunku do wartości globalnej umowy, w sytuacji, gdy Zamawiający nie ma uwag do umowy w części wykonanej do daty wypowiedzenia. W przeciwnym razie kara umowna powinna zostać uznana za wygórowaną zgodnie z art. 484 k.c.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

17. par. 5 ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie: Funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

18. par. 5 ust. 1 pkt 4)-5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z "500,00 zł" na "100,00 zł" za każdy przypadek?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

19. par. 5 ust. 1 pkt 6)-7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały wkalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

20. par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

21. par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? W przypadku braku zgody na usunięcie niniejszego postanowienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu "lecz nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu"?

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

22. par. 5 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”? Zaproponowana przez Zamawiającego wartość odbiega od rynkowego pułapu maksymalnego, który zazwyczaj sięga 10-20%. Nadto, należy mieć na uwadze, że wszelkie ryzyka finansowe związane z realizacją umowy będą musiały zostać wkalkulowane do ceny ofertowej Wykonawców.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

23. par. 6 ust. 4 pkt 5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5 mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą

zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

24. par. 7 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

25. par. 7 ust. 1 pkt 2)-3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania: „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: NIE - Zamawiający nie wyraża zgody.

26. par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

zał. nr 5 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

27. par. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby dodać następujące postanowienia:

"a. Czynności kontrolne nie mogą prowadzić do ujawnienia Zamawiającemu danych osobowych nieobjętych niniejszą umową, w szczególności danych osobowych innych klientów Wykonawcy, lub prowadzić do obniżenia skuteczności przyjętych przez Wykonawcę środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego organizacji bądź zagrażać lub prowadzić do obniżenia poziomu ich bezpieczeństwa.

b. Kontrola obejmuje swoim zakresem wyłącznie przetwarzanie danych osobowych, z wyłączeniem wszelkich informacji niejawnych, poufnych, czy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

c. Czynności audytowe odbywają się wyłącznie w obecności osoby wyznaczonej przez Wykonawcę

d. Czynności audytowe nie mogą utrudniać działalności Wykonawcy, w szczególności wykonywania obowiązków przez pracowników lub współpracowników Wykonawcy."

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

28. par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia poprzez dodanie następującego zdania: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę wyłącznie na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie planowanego audytu oraz zakresie jego prowadzenia z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem”.

29. par. 5 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy załącznika nr 1 z listą podmiotów podprzetwarzających, w tym na dodanie do Umowy par. 5 ust. 5 o treści „Lista podmiotów podprzetwarzających znanych na dzień podpisania niniejszej Umowy, z których usług Podmiot przetwarzający jest uprawniony do korzystania, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.”?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

30. par. 8 ust. 2 pkt 2.1 oraz pkt 2.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu: „po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.

31. par. 9 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: TAK - Zamawiający wyraża zgodę.